


つかみもみマッサージャー MD-520

取扱説明書

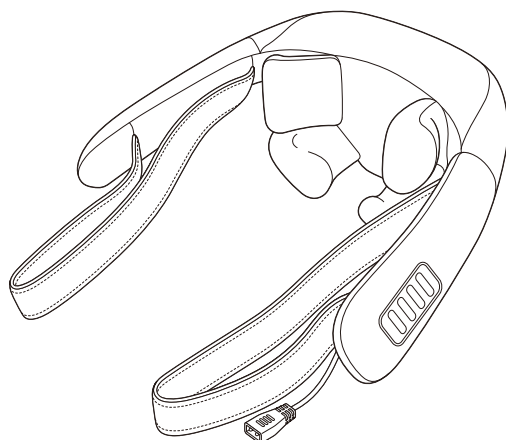

このたびはお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。

使用目的または効果

あんま、マッサージの代用

- 疲労回復
- 血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

一般家庭で使用するこ

もくじ

- 安全上のご注意……………1～4
- 各部の名称……………5
- ご使用の前に……………6・7
- 使いかた……………7・8
- 使用例……………9
- 使用上のご注意……………10
- お手入れについて……………10
- 保管について……………10
- 故障かなと思ったら……………11
- 愛情点検について……………11
- 電池のリサイクルについて…12
- 仕様……………13
- アフターサービスについて…14・15
- メモ……………16・17
- 無料修理規定……………18
- 保証書……………裏表紙

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
	注意	人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例

	○記号は、「禁止」の行為を示しています。(左図の場合は分解禁止)
	●記号は、行為を強制・指示するものです。(左図の場合は電源プラグを抜く)

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

 禁止	次の人は使用しない。 医師からマッサージを禁じられている人。(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など) 症状を悪化させる原因になります。
	マッサージ以外の目的には使用しない。また、頭、胸、腹、骨部へは使用しない。 事故やけがの原因になります。
	強く押しつけて使用しない。 皮膚や筋肉を痛める原因になります。
	乳幼児や自分で意思表示できない人に使わせない。 事故やけがの原因になります。
	安全に責任を負う人の監督または指示がない限り、子供や補助を必要とする人に使わせない。 事故やけがの原因になります。
	子供には本体の上に乗らせたり遊ばせたりしない。 事故やけがの原因になります。

 禁止	動作中にもみボールや、つかみアーム、振動ボールを握ったり、指を入れたりしない。 事故やけがの原因になります。
	本体内部に金属類や燃えやすいものを入れない。 感電やショート、火災の原因になります。
	落としたり、強い衝撃をあてない。 発熱や発火、感電、けが、故障の原因になります。
	物を載せたり、落下しやすいところに置いたりしない。 発熱や発火、感電、けが、故障の原因になります。
	電源コードやACアダプター、器具用プラグが破損したり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。電源コードやACアダプター、器具用プラグが破損した場合は、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに修理を依頼する。 そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。
	付属以外のACアダプターで使用しない。 また、付属のACアダプターで他の電気製品を使用しない。 発熱や発火、感電、けが、故障の原因になります。
	電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ACアダプターに巻きつけたりしない。また、重いものをのせたり、熱器具に近づけて使用しない。 感電や火災の原因になります。
	リチウムイオン電池を内蔵しているため、高温環境下での使用、保管、充電、放電や加熱したり火の中に入れない。 また、廃棄する場合を除いてリチウムイオン電池を取り外さない。 事故や火災の原因になります。
 分解禁止	フトンや毛布をかぶせたりコタツの中に入れて使用しない。 発火や故障の原因になります。
	ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。 また、ホットカーペットなどの暖房器具の上で使用しない。 火災の原因になります。
	水などをこぼしたり、ぬれた身体で使用しない。 発熱や発火、感電、けが、故障の原因になります。
 分解禁止	機器が故障したり、布カバーが破れた場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに連絡する。ACアダプターや電源コードが破損した場合は危険ですのでお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに交換の依頼をする。 勝手にファスナーを開けない。機器は改造しない。 火災や感電、けがの原因になります。

安全上のご注意

警告

 強制	医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。 ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●けんしゅう(腱鞘)炎の人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●本品を使用しても効果がみられない人 ●その他医療機関で治療中の入事故や体調不良をおこす原因になります。 使用前に必ず布カバーが破れていないか確認する。どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、ACアダプターを抜き、修理を依頼してください。けがや感電の原因になります。 ACアダプターは交流100Vで使用する。 火災や感電の原因になります。 器具用プラグやソケットは定期的に掃除する。 ホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、漏電火災の原因になります。
---	---


注意

 禁止	次のようなときは使用しない。 ●疲労が激しいとき ●酒に酔っているとき ●湿疹が生じているとき 体調不良をおこす原因になります。 食前、食後の1時間は使用しない。 体調不良をおこす原因になります。 他の治療器具と同時に使用しない。 体調不良をおこす原因になります。 使用中は眠らない。 事故やけがの原因になります。 肌の弱い人は素肌で使用しない。 けがややけがの原因になります。 施療部位にアクセサリなどの硬いものをつけて使用しない。 機構部に接触してけがの原因になります。 二人以上で同時に使用しない。 事故やけが、故障の原因になります。
--	--


 禁止	交流式で使用中にACアダプターや器具用プラグを抜かない。 故障の原因になります。 お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯、アイロンやドライヤーは使用しない。 変色、変形の原因になります。
 水場使用禁止	浴室など湿度の高い場所では使用しない。 感電やショート、故障の原因になります。
 強制	1回の使用時間は10分以内にする。 また、一箇所への連続使用は3分以内にする。 1日の使用時間は30分以内にする。 長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やけがの原因になります。 はじめは短い時間で使用する。 強い刺激に慣れていないと逆効果やけがの原因になります。 使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談する。 事故や体調不良をおこす原因になります。 使用後は電源ボタン(⏻)で動作を止め、電源ランプを消灯させたのち、ACアダプターをコンセントから抜く。 本品で遊ぶことがないよう子供を監視する。 子供のいたずらによる事故やけがの原因になります。 ACアダプターをコンセントから抜くときは電源コードを持たず、必ずACアダプターを持って引き抜く。器具用プラグをソケットから抜くときは電源コードを持たず、必ず器具用プラグとソケットを持って引き抜く。 感電やショート、故障の原因になります。 故障が見つかったら、すぐに使用を止め、ACアダプターをコンセントから抜く。 事故やけがの原因になります。 使用後は電源コードのねじれをほどいて保管する。 断線やショートの原因になります。
 電源プラグを抜く	充電時や交流式(ACアダプターを接続)で使用时以外はACアダプターをコンセントから抜く。 ホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、漏電火災の原因になります。 お手入れの際は、ACアダプターをコンセントから抜く。 また、ぬれた手でACアダプターにふれない。 感電ややけがの原因になります。 停電のときは、ACアダプターをコンセントから抜く。 停電復帰時に事故やけがの原因になります。

各部の名称


本 体

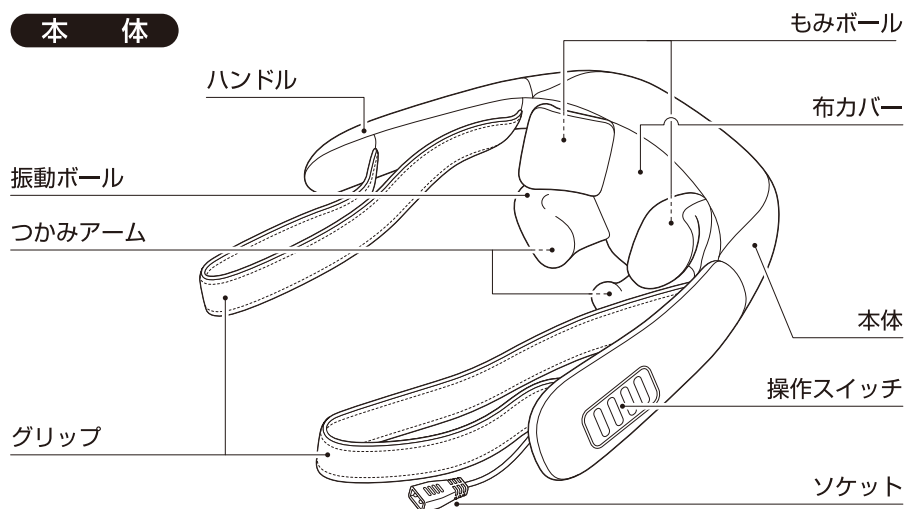

操作スイッチのボタンは、中央がボタン部、両サイドが表示部です。動作させるには中央部を押してください。

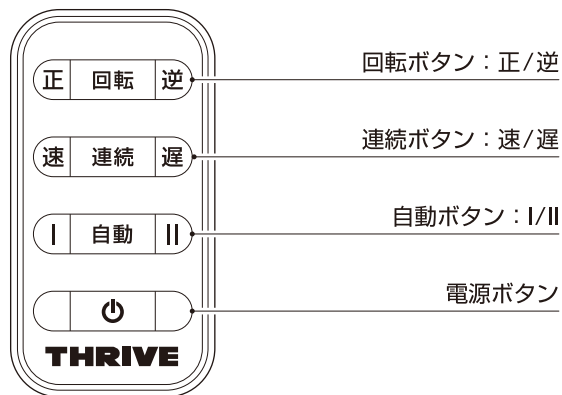

付 属 品

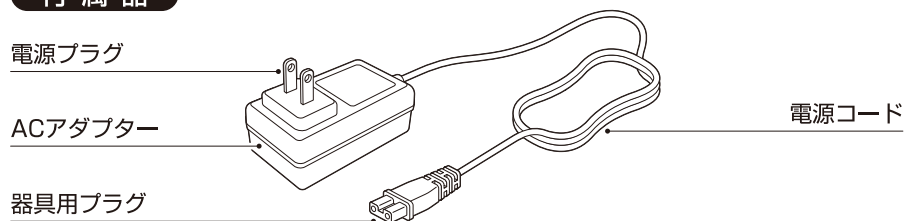

- 付属品は同梱されているものをお使いください。

ご使用の前に


充電式(コードレス)での使い方

はじめてご使用になる時、または長期間ご使用にならなかった時は、リチウムイオン電池が自己放電し、動かないことがありますので、ご使用前には必ず充電してからお使いください。

1. 器具用プラグをソケットに差し込んでください。
 2. ACアダプターをコンセントに差し込み、約140分充電をしてください。
(充電中は電源ランプが赤色に点滅し、充電が完了すると消灯します)。
 3. 充電が完了したら、ACアダプターをコンセントから抜き、ソケットから器具用プラグをはずしてください。
- 1回の充電で約60分使用できます。

電池容量が低下したときは、交流式(ACアダプターを接続)でのご使用も可能です。

- 使用中にACアダプターが少し温かくなりますが、異常ではありません。

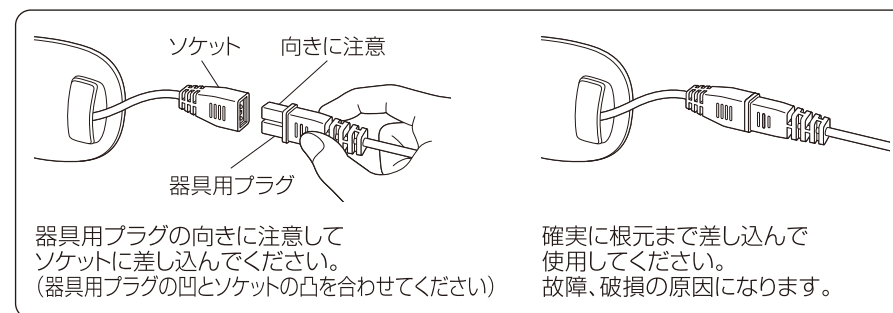


使用前に必ず布カバーが破れていないか確認し、破れがあるときはただちに使用を中止してください。

- 布カバーを外した状態や破れた状態で使用しないでください。
破れた場合は使用を中止し、ACアダプターを抜き、修理を依頼してください。
- 施療部位にアクセサリなどの硬いものをつけて使用しないでください。
事故やけが、故障の原因になります。
- 頭、胸、腹、骨部へは使用しないでください。事故やけがの原因になります。
- はじめはマッサージの動きを確認してから、弱い刺激を短い時間で使用してください。
- スイッチが正しく動作するか確認してください。

本品を持って首・肩にセットする際は、図1で示したハンドルの根元を持って行ってください。
ハンドルの先端やグリップを持って行くと、重みで頭部に本体などが当たり、事故やけがの原因になります。


(図1)

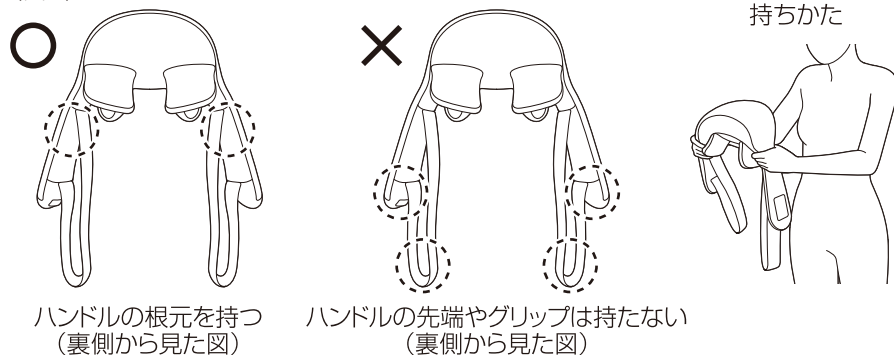

使いかた

本品は、もみボール、つかみアームによる「つかみもみ」と、振動ボールによる「振動刺激」により、首・肩をはじめとした各部位をマッサージします。

はじめに、電源ボタン  を押してください。
電源ランプが白色に点灯し、スタンバイモードになります。

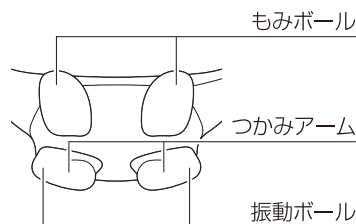

1. 自動

自動ボタンを押すと自動モードを開始します。ボタンを押すごとに「I」「II」が切り替わります。

〈自動:I〉

つかみもみと振動刺激を行いながら、リズム動作と速度の切り替えを織り交ぜたマッサージを行います。

〈自動:II〉

つかみもみと振動刺激を行いながら、ゆったりした動作で速度の切り替えを組み入れたマッサージを行います。



2. 連続

連続ボタンを押すと連続モードを開始します。
もみボールとつかみアームによるつかみもみと、振動ボールによる振動刺激によって一定の速度でマッサージを行います。
ボタンを押すごとに「速」「遅」が切り替わります。




回転方向(正転・逆転)の選択

連続モードでは回転ボタンを押して「回転方向」を選択できます。
「正」ランプが自動点灯し、ボタンを押すごとに「正」「逆」が切り替わります。
お好みで設定してから動作を開始してください。

動作中も切り替えることが可能です。


〈回転方向ランプ「正」〉

つかみアームが筋肉を下から押し上げ、もみボールが円を描くように内側からもみ込んでマッサージを行います。



〈回転方向ランプ「逆」〉

つかみアームが筋肉を下から押し上げ、もみボールが円を描くように外側からもみ込んでマッサージを行います。



●自動モードは回転方向(正転・逆転)も自動で切り替わります。

3. マッサージを終了したいときは、電源ボタン  を押してください。

動作が止まり、電源ランプが消灯し、電源OFFになります。

4. 交流式(ACアダプターを接続)で使用する場合は、ACアダプターをコンセントから抜き、次に器具用プラグをソケットから抜いてください。

オートタイマーについて

使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動的に止まります。


使用例



首・肩
グリップを持って使用



首・肩(ハンズフリー)
壁などに当てて使用

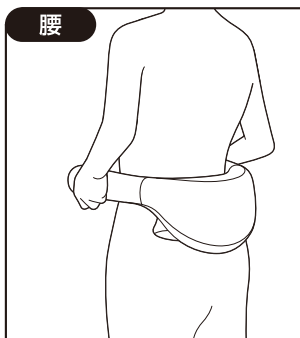

腰
ハンドルを持って使用



太もも
本体を持って使用



ふくらはぎ
ハンドルを持って使用

使用上のご注意

- 整髪料・化粧品などの薬品を接触させないでください。
化学変化による生地の変色や劣化の原因になります。
- 直射日光を毎日長時間あてないでください。
生地の変色や劣化の原因になります。

お手入れについて

柔らかい乾いた布でふき取ってください。

汚れがひどい場合は、ぬるま湯にうすめた中性洗剤を含ませた布をよくしぼってからふき、仕上げに乾いた布で水分をふき取ってください。

お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯、アイロンやドライヤーは使用しないでください。

変色・変形の原因になります。

保管について

- 汚れやホコリをとったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- しばらくご使用にならないときはカバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。
- 電源コードはねじれをほどこして保管してください。
- 本品の上に物を載せたり、落下しやすいところに置かないでください。
- 高温環境下で保管しないでください。
- 長期間使用しないときは、あらかじめ充電を完了させた状態で保管し、半年に1回は再度充電してください。
(電池の残量がない状態で保管すると、充電できなかつたり、電池の寿命が低下する原因になります)

故障かなと思ったら

点検、修理を依頼される前に下記のご確認をお願いします。

症 状	調べるところ
●布カバーがすれる音 ●マッサージ動作時の音	●構造上のもので機能などに影響はありません
●動作しない	●充電不足ではありませんか ●電源ボタンが点灯し、スタンバイモードになっていますか ●オートタイマーが働き停止状態になっていませんか ●使用環境温度内ですか +10℃～+35℃(リチウムイオン電池) +5℃～+35℃(ACアダプター)
●充電できない	●ACアダプターが抜けていませんか ●器具用プラグが抜けていませんか
●充電してもすぐに止まる	●フル充電を数回くり返して改善する場合があります ●それでも改善されない場合は電池の寿命と思われます

症 状	直し方
●連続使用中にマッサージが止まる	●モーターの温度上昇のため、安全装置が働いています しばらく本体を休ませて(2時間程度)から再度動作を確認してください

機器に異常音や動作しないなどの異常や故障が発見された場合は、ただちに使用を中止してください。ACアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理を依頼してください。

愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。

 愛情点検	このような症状はありませんか。 ●こげくさいにおいがする ●電源コード、ACアダプターが異常に熱い ●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする ●その他異常がある	 故障や事故防止のため使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜いて、必ずお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理をご相談ください。
---	--	---

電池のリサイクルについて



この製品に使用しておりますリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源ですので、リサイクルにご協力をお願い致します。本品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。(電池パックは短絡防止のため、必ず端子部に絶縁テープを貼ってください)。




警告

下記の手順は製品を廃棄するためのものであり、修理用のものではありません。
修理は、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターにご依頼ください。
分解した場合は修理不可能です。


電池の取り出しかた

- 動かなくなるまで動作させて電池を使いきってください。
- 本品を裏返し、本体の生地部をハサミなどで切り開いてください。

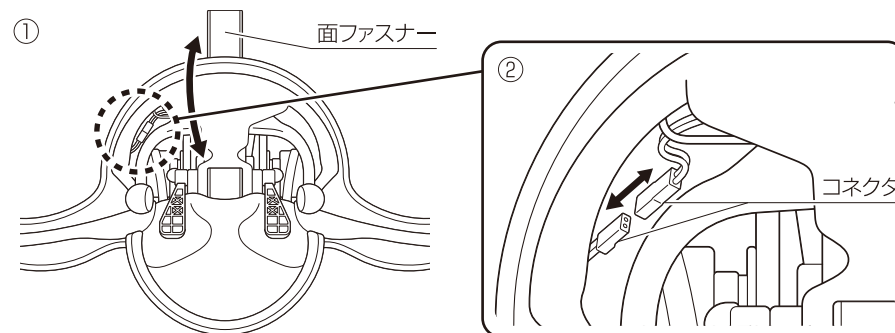

面ファスナーを取り外し、本体の生地部と布カバーを広げて機構部を取り出してください。

黒・赤コードがつながった白いコネクタが見えるので取り外してください。

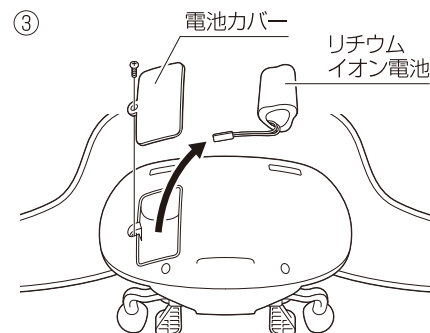

本体側を起こし、プラスドライバーで電池カバーのネジを外し、リチウムイオン電池を取り出してください。

仕様

販売名	つかみもみマッサージャー MD-520
医療機器認証番号	307AHBZX00009000
医療機器の種類	管理医療機器
一般的名称	家庭用電気マッサージャー
電源方式	充電・交流式
内蔵電池	リチウムイオン電池
充電時間	約140分
動作時間	約60分
使用環境温湿度	+10℃～+35℃(リチウムイオン電池) +5℃～+35℃(ACアダプター) 45%～85%RH
保管環境温度	-20℃～+45℃
充電回数	約500回
定格	AC100V 50/60Hz 25W
ACアダプター	IVP1200-2000P
定格時間	20分
オートタイマー	約10分
もみ回数	速 約12回/分 遅 約9回/分
振動回数	速 約1750回/分 遅 約1350回/分
外形寸法	幅 約27cm×奥行 約44cm×高さ 約17cm
質量	約1.9kg
電源コード長さ	約1.8m
材質	本体:ポリエステル 布カバー:ナイロン
付属品	ACアダプター
製造販売元	大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055

アフターサービスについて

- 保証書(裏表紙)
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 保証期間中に修理を依頼される場合
保証書の記載内容に従って修理いたします。
- 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間
弊社は補修用性能部品の製造打ち切り後最低6年間保有しております。
(ただし、縫製部品は除きます)。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- その他ご不明な場合
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または
お客様ご相談センターにお問い合わせください。

**地球の環境保護のため、廃棄するときにはそのまま放置しないで
各自治体の取り決めにしたがってください。**

お客様ご相談センターのご案内

製品の返品・返金などについては、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

製品のお取り扱い方法、修理などのご相談は

フリーダイヤル  **0120-064-762**

※お客様がご加入されている電話（NTT以外の一般回線、IP電話など）によっては、ご利用できない場合がございます。

上記番号がご利用できない場合は下記番号にお問い合わせください。

TEL 086-722-5110

FAX 086-722-3874

岡山大東電機工業株式会社

〒709-3104 岡山県岡山市北区建部町角石谷 1503-1

【受付時間（祝日を除く月～金）9:00～17:00】

都合によりお休みさせていただくことがあります。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。なお、お客様の個人情報は弊社で責任をもって管理し、第三者への開示や他の目的には使用いたしません。

メモ

〈無料修理規定〉

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店または、P15のお客様ご相談センターが無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ販売店または、P15のお客様ご相談センターに依頼してください。
3. ご転居の場合には事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼にできない場合には、P15のお客様ご相談センターにご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外(業務用など)に使用された場合の故障および損傷
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - (ト) 指定外電源(電圧・周波数)使用による損傷
6. 本書は国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または、P15のお客様ご相談センターにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはP14をご覧ください。

THRIVE

スライヴ

保証書

持込修理

つかみもみマッサージャー MD-520

お買い上げ日	保証期間
年 月 日	お買い上げ日より1年間

お客様	
フリガナ	
お名前	様
住所 〒	
電話番号	

販売店

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売などで購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は、お買い上げ販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

P18の無料修理規定をご覧ください。

製造販売元

大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38